

FR

F-815 Mode d'emploi WE-2018-F815

APPAREIL MULTIFONCTION

ADVERTISSEMENT

- N'essavez en aucune circonstance d'ouvrir ou d'inspecter les composants internes ou les accessoires de votre appareil. Si une inspection est nécessaire, veuillez contact votre fournisseur ou un technicien qualifié.
- N'utilisez jamais votre appareil dans un lieu humide ou peu ventilé (par exemple, salles de bains); ceci pourrait endommager les composants électriques de votre
- N'utilisez jamais votre appareil à l'extérieur, une exposition aux éléments naturels pouvant endommager
- Si le cordon d'alimentation était rompu, veuillez demander à un professionnel de le remplacer pour éviter tout dommage, ou demandez conseil à votre revendeur.
- Ne laissez aucune sonde à ultrasons allumée sans surveillance. Elles risquent de surchauffer, ce qui pourrait provoquer un dommage à la sonde ou une réduction de sa durée de vie
- Ne tentez pas de séparer le générateur en acier inoxydable de son support en caoutchouc (manche), tout essai pouvant causer des dommages irréparables au aénérateur

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ce produit répond aux exigences suivantes:

- Conditions énoncées dans la Directive «Basse tension»: —
- 2. Conditions énoncées dans la Directive «Compatibilité électromagnétique»: 2014/30/EU.

RECYCLAGE

Si l'un des composants électriques ou leur emballage de présentation porte ce symbole, cela signifie que ces produits ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers habituels. Afin de leur assurer un traitement approprié, veuillez vous en débarrasser en respectant les lois locales ou tel que requis en cas d'élimination d'appareils électriques. Ceci permettra de préserver et de sauver les ressources naturelles et d'améliorer les normes de protection de l'environnement portant sur l'élimination de déchets


BIENVENUE!

Merci beaucoup d'avoir fait cet achat. Veuillez lire les instructions avec attention avant d'utiliser cet appareil. Vous pouvez également demander conseil auprès d'un professionnel afin de vous assurer d'utiliser l'appareil correctement. Nous n'endosserons aucune responsabilité en cas d'accident provoqué par une mauvaise utilisation L'entreprise se réserve le droit de modifier les détails des instruments sans préavis. Si vous détectez une erreur dans ces instructions, n'hésitez pas à nous le faire savoir afin d'y apporter une solution.

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- Ces elements sont sujets à changement sans préavis.
- L'apparence du produit peut différer de l'image.

No.	PRODUIT	RÉF.	QTÉ.
1	ÉLECTRODE 1	10009	1
2	ÉLECTRODE 2	10010	1
3	ÉLECTRODE 3	10011	1
4	ÉLECTRODE 4	10012	1
5	POIGNÉE HAUTE FRÉQUENCE	10040	1
6	SONDE YEUX PETITE	10037	1
7	SONDE VISAGE PETITE	10038	1
8	POIGNÉE GALVANIQUE	10004	1
9	CABLES GALVANIQUES		1
10	ACCESSOIRES GALVANIQUES	-	2
11	ACCESSOIRES GALVANIQUES	-	2
12	TUYAU	10029	1
13	BOUTEILLE SPRAY	10033	1
14	POIGNÉE	10028	1
15	TÊTE D'ASPIRATION 1	10027	1
16	TÊTE D'ASPIRATION 2		1
17	TÊTE D'ASPIRATION 3		1
18	UNITÉ PRINCIPALE	-	1
19	CÂBLE ALIMENTATION	-	1

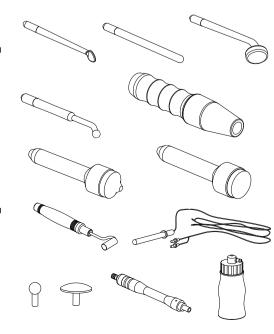



PANNEAU AVANT



- 1. Poignée galvanique
- 2. Poignée haute fréquence
- 4. Sonde yeux 5. Tuyau bouteille spray
- 6. Tuyau manche spray
- 7. Câble alimentation

MODE D'EMPLOI

- 1. Branchez la source d'alimentation sur le panneau arrière, indiqué sur le schéma par l'expression «POWER LINE
- 2. Branchez les accessoires correctement sur le panneau avant ou arrière comme indiqué sur le schéma
- 3. Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton

HAUTE FRÉQUENCE


1. Choisissez le tuyau d'électrode en verre adapté et insérez l'extrémité en métal dans la partie de rendement du manche (veillez à ne pas toucher l'électrode de verre avec vos mains ou tout autre objet en métal).

Types de tuyaux d'électrode en verre:

- a. Tuyau d'électrode en forme de champignon: utilisé sur de larges zones de peau, comme par exemple le visage, le front, le cou, etc.
- **b.** Tuyau d'électrode en forme de louche: utilisé sur des zones moyennes, telles que le menton, etc.
- c. Tuyau d'électrode en forme de balle: utilisé sur de petites zones, comme le nez, etc.
- d. Tuyau d'électrode droit: utilisé en cas de traitement
- 2. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton «HFREQUENCY» et assurez-vous que l'option «H/ENERGY» est réglée sur le minimum.
- 5. Touchez la zone de traitement avec l'électrode en verre. Vous pouvez ensuite ajuster doucement l'éjection en réglant l'option «H/ENERGY».
- 6. Au cours du traitement, veuillez réduire le niveau de rendement au niveau minimal avant tout changement d'électrode, puis ajustez lentement le niveau d'énergie et choisissez l'intensité souhaitée.
- 7. À la fin du traitement, réduisez doucement l'option «H/ENERGY» au niveau minimal puis éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton «H. FREQUENCY avant de retirer l'électrode du visage du client.

USAGE INDIRECT

1. Choisissez l'électrode en verre droite et insérez l'extrémité en métal dans la partie de rendement du manche.



- 2. Donnez le combiné au client, en vous assurant que le client tient l'électrode en verre et non le manche
- 3. Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton «H. FREQUENCY» et en vous assurant que l'option «H/ENERGY» est réglée au minimum.
- 4. Ajustez doucement l'éjection en réglant l'option
- 5. Effectuez le massage facial ou le traitement en utilisant le produit prescrit comme demandé. Pendant toute la durée du traitement, assurez-vous de ne pas toucher ou entrer en contact avec l'électrode en verre tenue par le client.
- 6. À la fin du traitement, réduisez doucement l'option «H/ENERGY» jusqu'au minimum puis éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton «H. FREQUENCY»

CAUTIONS

haute fréquence

- L'électrode en verre brillera lorsque se trouve à moins de 2 cm de la peau lorsque l'instrument est allumé. Dans ce cas, réduisez l'énergie de l'appareil à haute fréquence. Si le client sent toujours l'étincelle, il peut se couvrir le visage avec une petite serviette en coton mais iamais avec une serviette en nylon ou synthétique
- Avant de retirer l'électrode de verre de la peau, réduisez l'option «ENERGY» à son minimum puis éteignez l'appareil avant de le retirer de la peau.
- Les clients ne peuvent pas porter d'objets en métal ou de bijoux ; tous les objets doivent être retirés avant de commencer le traitement.
- Les femmes enceintes ou les personnes ayant un pacemaker (ou tout appareil électrique ou de régulation des battements du cœur) ne peuvent pas être soumis à des traitements à haute fréquence.
- Les produits utilisés lors d'un traitement à haute fréquence ne doivent contenir ni alcool ni substance à base d'alcool afin d'empêcher toute combustion accidentelle.
- Ne touchez jamais l'intérieur de l'œil avec une électrode à
- Veillez à ne toucher que la poignée du combiné à haute

fréquence

ULTRASONS

AVANT LE TRAITEMENT:

1. Nettoyez/tonifiez la zone de traitement en utilisant les

- produits adaptés à chaque type de peau 2. Retirez le surplus de produit grâce à une vaporisation
- 3. Nettoyez la zone de traitement à nouveau pour retirer toutes les impuretés ou restes du visage afin d'empêcher que les ondes ultrasons ne soient renvoyées dans le derme
- 4. Tonifiez doucement chaque partie du visage (ou de la zone de traitement) en utilisant l'astringent adapté.
- 5. Après avoir retiré l'astringent, la peau sera correctement
- nettoyée pour une protection optimale. 6. Appliquez du gel conducteur en quantité suffisante sur la

AU DÉBUT DU TRAITEMENT:

1. Ajustez l'intensité grâce au régulateur «U/ENERGY». Il est recommandé de commencer avec 3 ou 4 blocs sur l'écran LCD.


- 2. Appuyez sur le bouton «ULTRASOUND» pour
- 3. Sélectionnez le type d'ondes souhaité en appuyant sur le bouton «STATE». Il existe deux types d'ondes: l'onde continue et l'onde combinée.
- 4. Sélectionnez le port de sortie souhaité en appuyant sur le bouton «SELECT». R correspond au port droit et L au port gauche.
- 5. Massez la zone de traitement sur laquelle le gel conducteur avait été appliqué avec de petits mouvements circulaires afin de couvrir toute la zone de traitement. Le temps de traitement variera en fonction de la taille de la zone à traiter. Un traitement facial complet (massages répétitifs) dure habituellement entre 10 et 15 minutes.
- 6. À la fin du traitement, éteignez et remettez la sonde en

- Assurez-vous d'appliquer le gel conducteur en quantité suffisante pour un traitement de 15 minutes minimum
- Il est recommandé d'utiliser des éjections basses pour des massages faciaux et des éjections plus élevées pour
- Si la zone de traitement est petite ou sensible, utilisez la sonde d'œil et assurez-vous que le niveau de rendement énergétique est limité à 5 à 7 blocs sur l'écran LCD «ENERGY». Le temps de traitement peut également être réduit à 8 à 10 minutes.
- Un traitement standard dure environ 10 sessions au total, avec un minimum de 24 heures entre chaque session. Si d'autres traitements faciaux sont effectués sur la même zone, un délai minimum de 7 jours doit être maintenu entre chaque traitement.

CAUTIONS

- N'utilisez pas cet instrument sur une peau sèche.
- N'utilisez pas cet instrument sur l'estomac d'une femme
- N'utilisez pas cet instrument sur des personnes portant un pacemaker (tout appareil électrique ou de régulation des battements du cœur).
- N'utilisez pas cet instrument sur des personnes ayant des conditions cardiaques ayant été diagnostiquées.
- Utilisez toujours des électrodes ultrasons sur une peau suffisamment humidifiée ou après application d'un sérum.
- Le traitement par ultrasons peut être appliqué à tous types de peaux. Le temps de massage et les options de massage peuvent être adaptés à chaque type de peau. Pour les peaux sensibles, il est recommandé de réduire le temps de traitement à 3-5 minutes et assurez-vous que la puissance est sur le minimum au début du traitement.

GALVANIQUE



CONTRE-INDICATIONS

- Pacemaker (ou tout appareil électrique ou de régulation des battements du cœur)
- Thrombose/phlébite Maladies de peau
- Opération dans les six derniers mois
- Implants en silicone
- Peau hyper-sensible ou vasculaire

AVANT LE TRAITEMENT:

1. La zone de traitement doit être nettoyée et séchée avant d'appliquer tout produit qui pénètrera les tissus.

- 2. Le client tient le bout en métal et le thérapiste tient la poignée de la roulette
- 3. La polarité des sondes peut être modifiée en ajustant le bouton «LEAD» entre (+R) et (-G).

Pôle positif (anode)	Pôle négatif (cathode)	
+R	-G	
Rouleau/bille (+), métal pôle (-)	Rouleau/bille (-), métal pôle (+)	
Des solutions de pH acide	Des solutions de pH alcalin	

4. Couvrez la roulette/balle avec un bout de coton ou une éponge préalablement trempée dans une lotion adaptée (selon le traitement effectué). La lotion peut également être appliquée directement sur la peau.

AU DÉBUT DU TRAITEMENT: 1. Mettez la fonction «IONOS» en marche et assurez-vous

que le régulateur «I/ENERGY» est réglé au rendement

- 2. Sélectionnez l'opération souhaitée en appuyant sur le bouton «LEAD»
- 3. Touchez la zone traitée avec la roulette/balle.
- 4. Ajustez doucement le bouton «I/ENERG » jusqu'à l'intensité appropriée, lorsque le client sent une petite pigûre. Faites rouler doucement la roulette. Le coton doit retenir l'humidité au maximum pour obtenir le meilleur effet

CAUTIONS

- Assurez-vous à chaque utilisation que les clients retirent. tous leurs bijoux, et confirmez qu'aucun implant métallique (broches, articulations, etc.) ne leur a été installée depuis leur dernier traitement
- Les femmes enceintes et les personnes avant une peau sensible, blessée, enflammée ou souffrant d'une expansion des vaisseaux sanguins ne doivent pas être soumises à ce
- Les clients avant des problèmes de santé tels qu'une maladie cardiaque ou des maladies infectieuses et une peau hyper-allergique ou hyper-sensitive (voir contre-
- Assurez-vous toujours que la surface de la peau a été largement humidifiée avec un produit conducteur
- Lors de l'utilisation, la roulette ne doit pas entrer en contact avec l'élément en métal. Si cela se produisait, l'instrument doit être protégé et l'éjection s'arrêtera automatiquement. À cet instant, éteignez la fonction «I/ENERGY» et redémarrez l'instrument en rallumant la fonction «I/ENERGY». Lorsque vous éteignez l'instrument veillez à éteindre la fonction «I/ENERGY» avant d'éteindre la fonction «IONOS».

ASPIRATION ET PULVÉRISATION

ASPIRATION

1. Branchez l'extrémité opposée du tuyau au manche d'aspiration. Introduisez le petit tuyau d'aspiration en verre à utiliser dans le manche. Il existe quatre types de tuyaux d'aspiration en verre.



2. Vérifiez que le filtre en mousse est correctement placé dans le manche.

3. Appuyez sur le bouton «VAC-SPRAY» sur le panneau 4. Vous pouvez ajuster l'effet d'aspiration en couvrant et découvrant le trou sur le côté du manche avec votre doigt.

• L'opération ne doit normalement excéder 5 minutes. Si l'instrument surchauffe, éteignez tous les boutons puis redémarrez l'appareil après 10 minutes.

PULVÉRISATION 1. Remplissez les bouteilles avec le liquide adapté. Il existe deux types de bouteilles de pulvérisation, qui contiennent des liquides différents

2. Branchez l'autre extrémité du tuyau à la bouteille de





- 3. Appuyez sur le bouton «VAC-PRAY» sur le panneau
- 4. Vous pouvez ajuster l'effet d'aspiration en couvrant et découvrant le trou du haut de la bouteille avec votre doigt.

NOTES

- Veillez à pulvériser en commencant par le front lors du traitement. Empêchez le liquide d'entrer dans le nez. Demandez au client de fermer les yeux et la bouche.
- Veillez à garder une distance suffisante entre l'appareil et le visage au cours de la pulvérisation afin que l'effet soit ressenti comme atterrissant sur la peau.
- L'opération ne doit normalement pas excéder 5 minutes. En cas de surchauffe de l'instrument, éteignez tous les boutons et redémarrez l'appareil après 10 minutes

- CAUTIONS • Le régulateur de pression peut être dévissé le revisser et la machine continue de fonctionner correctement
- Ne laissez pas le manche sur la même zone trop longtemps car cela peut provoquer des blessures.
- Évitez d'utiliser l'appareil sur une peau irritée
- Assurez-vous que le tuyau de pulvérisation est toujours branché au bon embout sur l'appareil afin d'empêcher une aspiration accidentelle de toute solution de pulvérisation dans la pompe; ceci pouvant endommager l'appareil et annuler la garantie du fabriquant.
- Ne faites pas fonctionner la pompe d'aspiration ou de pulvérisation pendant de longues périodes de temps sans laisser un temps de refroidissement entre chaque traitement afin d'empêcher une surchauffe de la pompe et un endommagement de l'appareil. La garantie du fabriquant ne couvre pas les endommagements provoqués par une surchauffe.

FAQ

ULTRASONS Vérifiez ce qui suit si l'appareil est allumé mais que les

sondes à ultrasons n'émettent pas d'ondes:

- Versez une goutte d'eau sur une sonde.
- Allumez l'appareil et augmentez doucement le niveau de
- Si l'eau se met en mouvement ou s'évapore, l'appareil et

L'appareil et les sondes fonctionnent correctement mais le

Assurez-vous d'avoir appliqué suffisamment de gel

GALVANIQUE

Vérifiez ce qui suit si les roulettes de la sonde ne tournent

• Démontez et nettoyez complètement.

conducteur sur la zone de traitement.

Si la roulette ne fonctionne toujours pas correctement,

MAINTENANCE

HAUTE FRÉQUENCE

• Les tuyaux d'électrode en verre doivent être gardés propres et secs, et doivent être stérilisés avant et après

ULTRASONS

• Les sondes à ultrasons doivent être nettoyées en utilisant de l'eau claire (pas chaude) et un chiffon doux puis stérilisées chimiquement en utilisant le liquide de

• Prenez garde à ne pas endommager les roulettes de la sonde. N'utilisez à aucun moment de substance abrasive pour nettoyer les roulettes de la sonde ; car si la surface de la roulette se voyait endommagée, cela pourrait provoquer un dommage à la peau lors du traitement. Toute zone endommagée pourrait alors héberger des bactéries et cela rendrait la stérilisation plus difficile.

 Après le traitement, toutes les parties métalliques de la roulette doivent être nettoyées, stérilisées et séchées, puis gardées dans un endroit approprié pour éviter tout

Démontez le manche et changez le filtre. Puis réassemblez le manche.

ACCESSOIRES DESCRIPTION ÉLECTRODE 1 10009 10010 ÉLECTRODE 2 ÉLECTRODE 3 10011 10012 ÉLECTRODE 4 10024 ÉLECTRODE SPÉCIALE 1

10025 ÉLECTRODE SPÉCIALE 2 ÉLECTRODE SPÉCIALE 3 10026 10040 POIGNÉE HAUTE FRÉQUENCE 10037 SONDE YEUX PETITE 10038 SONDE VISAGE PETITE 10004 POIGNÉE GALVANIQUE CÂBLES GALVANIQUES

Poids brut (kg) Dimensions produit (cm) 41x17/24x13 Puissance de travail Fréquence de travail (ultrasons) Puissance de travail (ultrasons) Fréquence de travail (haute 180 KHz fréquence) Puissance de travail (galva-5 W nique) Intensité de travail (galvanique) 380 - 1000 mi cro Amperes 0 ~ -0,075 MPa Pression d'aspiration Caracté-Tension nominale 220V ~ 240V ristiques Fréauence 50Hz/60Hz Puissance nominale 80 W triques

Vous trouverez plus d'information sur le site: www.weelko.com Importateur: Weelko Barcelona, S.L. ESB65397556

les sondes fonctionnent correctement. Si non, les sondes

ne fonctionnent pas correctement.

client ne sent aucun effet

- veuillez contacter votre revendeur.

chaque utilisation

stérilisation approprié. Séchez la sonde avec attention après la stérilisation et gardez-la dans son rangement sur le guéridon entre chaque utilisation. Stérilisez toujours les sondes avant toute nouvelle utilisation. • N'immergez à aucun moment la sonde dans un fluide

ASPIRATION ET PULVÉRISATION • Le filtre en mouse doit être changé après 5 traitements.

10029 TUYAU 10033 **BOUTEILLE SPRAY**

POIGNÉE

Taille de l'emballage (cm)

TÊTE D'ASPIRATION 1

TÊTE D'ASPIRATION 2

TÊTE D'ASPIRATION 3

SPÉCIFICATIONS

10028

Caractéristiques de travail

© 2018 Weelko

45x36x18.5